

Rolflex
TONIC[®]

Total Knee Prosthesis for Primary
and Revision Indications

*Prothèse Totale de Genou pour
Indications Primaires et Révision*


There is no joint
in the human
body on which
the locomotion
has imposed a
heavier load,
and there is
no joint either
more prompt to
experience the
abuse.

Build a joint
so exposed
to mechanical
stresses with
any insurance
of safety was
attempting the
impossible for
the ingenuity of
the nature.



A.Steindler ⁽¹⁾

REFERENCES

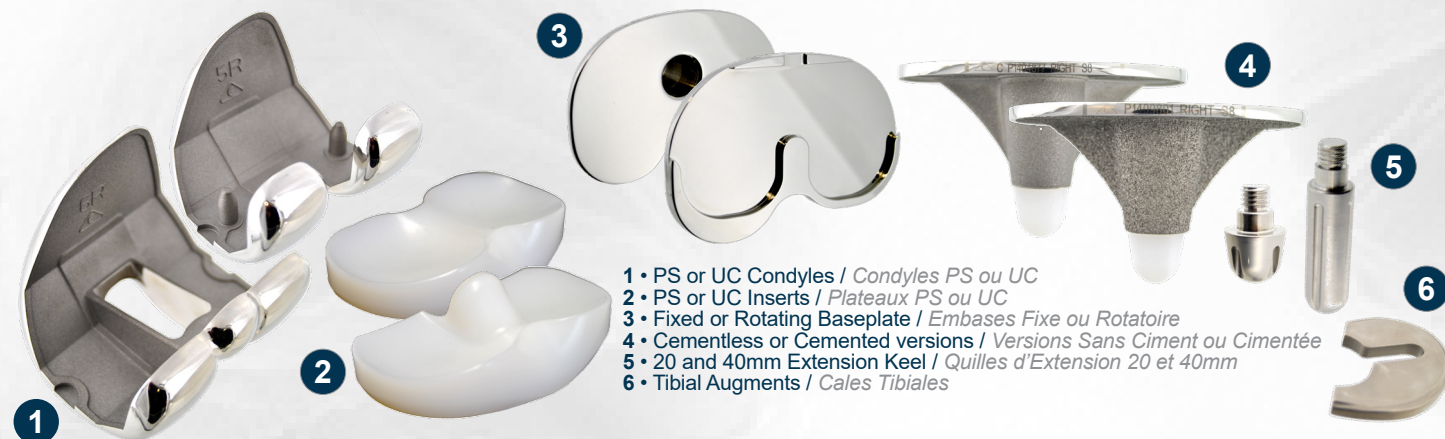

- 1 • PS or UC Condyles / Condyles PS ou UC
- 2 • PS or UC Inserts / Plateaux PS ou UC
- 3 • Fixed or Rotating Baseplate / Embases Fixe ou Rotatoire
- 4 • Cementless or Cemented versions / Versions Sans Ciment ou Cimentée
- 5 • 20 and 40mm Extension Keel / Quilles d'Extension 20 et 40mm
- 6 • Tibial Augments / Cales Tibiales

Condyles Condyles	PS / Postéro-Stabilisés								UC / Ultra-congruents								Patella Rotule					
	Cemented / A cimenter				Cementless / Sans ciment				Cemented / A cimenter				Cementless / Sans ciment									
	R / D		L / G		R / D		L / G		R / D		L / G		R / D		L / G							
	Sz./T 1	G33 FPCD01		G33 FPCG01		G33 FPRD01		G33 FPRG01		G33 FUCD01		G33 FUCG01		G33 FURD01		G33 FURG01						
Sz./T 2	G33 FPCD02		G33 FPCG02		G33 FPRD02		G33 FPRG02		G33 FUCD02		G33 FUCG02		G33 FURD02		G33 FURG02							
Sz./T 3	G33 FPCD03		G33 FPCG03		G33 FPRD03		G33 FPRG03		G33 FUCD03		G33 FUCG03		G33 FURD03		G33 FURG03							
Sz./T 4	G33 FPCD04		G33 FPCG04		G33 FPRD04		G33 FPRG04		G33 FUCD04		G33 FUCG04		G33 FURD04		G33 FURG04							
Sz./T 5	G33 FPCD05		G33 FPCG05		G33 FPRD05		G33 FPRG05		G33 FUCD05		G33 FUCG05		G33 FURD05		G33 FURG05							
Sz./T 6	G33 FPCD06		G33 FPCG06		G33 FPRD06		G33 FPRG06		G33 FUCD06		G33 FUCG06		G33 FURD06		G33 FURG06							
Sz./T 7	G33 FPCD07		G33 FPCG07		G33 FPRD07		G33 FPRG07		G33 FUCD07		G33 FUCG07		G33 FURD07		G33 FURG07							
Sz./T 8	G33 FPCD08		G33 FPCG08		G33 FPRD08		G33 FPRG08		G33 FUCD08		G33 FUCG08		G33 FURD08		G33 FURG08							
Sz./T 9	G33 FPCD09	(1)	G33 FPCG09	(1)	G33 FPRD09	(1)	G33 FPRG09	(1)	G33 FUCD09	(1)	G33 FUCG09	(1)	G33 FURD09	(1)	G33 FURG09	(1)						
Tibial Baseplate Embase tibiale	Fixed / Fixe								Rotating / Rotatoire								Tibial Keel Quille Tibiale					
	Cemented / A cimenter				Cementless / Sans ciment				Cemented / A cimenter				Cementless / Sans ciment									
	R / D		L / G		R / D		L / G		R / D		L / G		R / D		L / G							
	Sz./T 0	G33 TFCD00	(1)	G33 TFCG00	(1)	G33 TFRD00	(1)	G33 TFRG00	(1)	G33 TMCD00	(1)	G33 TMCG00	(1)	G33 TMRD00	(1)	G33 TMRG00	(1)					
Sz./T 1	G33 TFCD01	(1)	G33 TFCG01	(1)	G33 TFRD01	(1)	G33 TFRG01	(1)	G33 TMCD01	(1)	G33 TMCG01	(1)	G33 TMRD01	(1)	G33 TMRG01	(1)						
Sz./T 2	G33 TFCD02		G33 TFCG02		G33 TFRD02		G33 TFRG02		G33 TMCD02		G33 TMCG02		G33 TMRD02		G33 TMRG02							
Sz./T 3	G33 TFCD03		G33 TFCG03		G33 TFRD03		G33 TFRG03		G33 TMCD03		G33 TMCG03		G33 TMRD03		G33 TMRG03							
Sz./T 4	G33 TFCD04		G33 TFCG04		G33 TFRD04		G33 TFRG04		G33 TMCD04		G33 TMCG04		G33 TMRD04		G33 TMRG04							
Sz./T 5	G33 TFCD05		G33 TFCG05		G33 TFRD05		G33 TFRG05		G33 TMCD05		G33 TMCG05		G33 TMRD05		G33 TMRG05							
Sz./T 6	G33 TFCD06		G33 TFCG06		G33 TFRD06		G33 TFRG06		G33 TMCD06		G33 TMCG06		G33 TMRD06		G33 TMRG06							
Sz./T 7	G33 TFCD07		G33 TFCG07		G33 TFRD07		G33 TFRG07		G33 TMCD07		G33 TMCG07		G33 TMRD07		G33 TMRG07							
Sz./T 8	G33 TFCD08	(1)	G33 TFCG08	(1)	G33 TFRD08	(1)	G33 TFRG08	(1)	G33 TMCD08	(1)	G33 TMCG08	(1)	G33 TMRD08	(1)	G33 TMRG08	(1)						
Tibial insert Plateau tibial	Fixed / Fixe								Rotating / Rotatoire								UC / Ultra-congruent					
	PS / Postéro-stabilisé				PS / Postéro-stabilisé				PS / Postéro-stabilisé				UC / Ultra-congruent									
	h.10mm		h.12mm		h.15mm		h.18mm		h.10mm		h.12mm		h.15mm		h.10mm		h.12mm		h.15mm			
	Sz./T 0	G33 IFP010	(1)	G33 IFP012	(1)	G33 IFP015	(1)	-	-	G33 IMP110	(1)	G33 IMP112	(1)	G33 IMP115	(1)	G33 IMP118	(1)	G33 IMU110	(1)	G33 IMU112	(1)	G33 IMU115
Sz./T 1	G33 IFP110	(1)	G33 IFP112	(1)	G33 IFP115	(1)	G33 IFP118	(1)	G33 IMP210		G33 IMP212		G33 IMP215		G33 IMP218	(1)	G33 IMU210		G33 IMU212		G33 IMU215	
Sz./T 2	G33 IFP210		G33 IFP212		G33 IFP215		G33 IFP218	(1)	G33 IMP310		G33 IMP312		G33 IMP315		G33 IMP318	(1)	G33 IMU310		G33 IMU312		G33 IMU315	
Sz./T 3	G33 IFP310		G33 IFP312		G33 IFP315		G33 IFP318	(1)	G33 IMP410		G33 IMP412		G33 IMP415		G33 IMP418	(1)	G33 IMU410		G33 IMU412		G33 IMU415	
Sz./T 4	G33 IFP410		G33 IFP412		G33 IFP415		G33 IFP418	(1)	G33 IMP510		G33 IMP512		G33 IMP515		G33 IMP518	(1)	G33 IMU510		G33 IMU512		G33 IMU515	
Sz./T 5	G33 IFP510		G33 IFP512		G33 IFP515		G33 IFP518	(1)	G33 IMP610		G33 IMP612		G33 IMP615		G33 IMP618	(1)	G33 IMU610		G33 IMU612		G33 IMU615	
Sz./T 6	G33 IFP610		G33 IFP612		G33 IFP615		G33 IFP618	(1)	G33 IMP710		G33 IMP712		G33 IMP715		G33 IMP718	(1)	G33 IMU710		G33 IMU712		G33 IMU715	
Sz./T 7	G33 IFP710		G33 IFP712		G33 IFP715		G33 IFP718	(1)	G33 IMP810		G33 IMP812		G33 IMP815		G33 IMP818	(1)	G33 IMU810		G33 IMU812		G33 IMU815	
Sz./T 8	G33 IFP810	(1)	G33 IFP812	(1)	G33 IFP815	(1)	G33 IFP818	(1)	G33 IMP910	(1)	G33 IMP912	(1)	G33 IMP915	(1)	G33 IMP918	(1)	G33 IMU910	(1)	G33 IMU912	(1)	G33 IMU915	(1)
Sz./T 9																						
Augment Cale	Tibial / Tibiale								Mentions obligatoires :													
	h.5mm				h.10mm				Les implants ROLFLEX TONIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTG) de genou. Les implants ROLFLEX TONIC sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Pour plus de précision, merci de vous rendre sur le site www.ameli.fr . Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0315 incluse dans le conditionnement du DM ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com , ainsi que du manuel de technique opératoire G34 451 (Rolflex TONIC coupes indépendantes) ou G34 452 (Rolflex TONIC coupes dépendantes) ou G34 455 (Rolflex TONIC coupe fémorale première) et G34 453 (Implant patellaire inlay) ou G34 454 (Implant patellaire onlay) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com .													
	h.5mm		h.10mm																			
	Sz./T. 0	G33 CT0500	(1)	G33 CT1000	(1)																	
Sz./T. 1	G33 CT0501	(1)	G33 CT1001	(1)																		
Sz./T. 2	G33 CT0502	(1)	G33 CT1002	(1)																		
Sz./T. 3	G33 CT0503	(1)	G33 CT1003	(1)																		
Sz./T. 4	G33 CT0504	(1)	G33 CT1004	(1)																		
Sz./T. 5	G33 CT0505	(1)	G33 CT1005	(1)																		
Sz./T. 6	G33 CT0506	(1)	G33 CT1006	(1)																		
Sz./T. 7	G33 CT0507	(1)	G33 CT1007	(1)																		
Sz./T. 8	G33 CT0508	(1)	G33 CT1008	(1)																		

Mentions obligatoires :

Les implants ROLIFLEX TONIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTG) de genou.

Les implants ROLIFLEX TONIC sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Pour plus de précision, merci de vous rendre sur le site www.ameli.fr.

Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0315 incluse dans le conditionnement du DM ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com, ainsi que du manuel de technique opératoire G34 451 (Rolflex TONIC coupes indépendantes) ou G34 452 (Rolflex TONIC coupes dépendantes) ou G34 455

(Rolflex TONIC coupe fémorale première) et G34 453 (Implant patellaire inlay) ou G34 454 (Implant patellaire onlay) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

(1) Sizes of implants available only on request, not included in the standard set.

(1) Taille d'implants disponibles uniquement sur demande, non inclus dans la gamme livrée en standard.

Materials / Matériaux :

Condyles : CoCr according ISO5832-4 (cemented) or CoCr according ISO5832-4 coated with macroporous Ti (cementless)

Tibial Baseplate : CoCr according ISO5832-4 (cemented) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 or CoCr according ISO5832-4 coated with macroporous Ti (cementless) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2

Tibial Insert : PEXEL® UHMWPE according ISO 5834-1 & 2

Patella : PEXEL® UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 and Stainless Steel according ISO 5832-1

Tibial keel : CoCr according ISO5832-12. Augment : CoCr according ISO5832-4

Vacuum packaging VacUPac®. Gamma ray sterilised.

Condyles : CrCo selon ISO5832-4 (cimenté) ou CrCo selon ISO5832-4 revêtu Ti macroporeux (sans ciment)

Embase tibiale : CrCo selon ISO5832-4 (cimenté) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 ou CrCo selon ISO5832-4 revêtu Ti macroporeux (sans ciment) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2

Plateau Tibial : UHMWPE PEXEL® selon ISO 5834-1 et 2

Rotule : UHMWPE PEXEL® selon ISO 5834-1 et 2, et Inox selon 5832-1

Quille Tibiale : CrCo selon ISO5832-12. Cale : CrCo selon ISO5832-4

Conditionnement sous vide VacUPac®. Stérilisation gamma.